



Руководитель (заместитель руководителя)

м.п.

Федеральной службы по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия

ДИТВАК А.Г.

180618  
Приложение

к аттестату аккредитации  
№ РОСС RU.0001.310389

от " " 201 г.

На 2 листах, лист 1

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

### Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИОН» (ООО «ДИКСИОН»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется)

индивидуального предпринимателя

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2

адрес места осуществления деятельности

### Поверка средств измерений

ГТД

шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
<b>СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>				
1	Электрокардиоанализаторы	минус 5,0-5,0 мВ 0,03-4,0 мВ	ПГ ±5 % ПГ ±15 %	
2	Системы суточного мониторинга ЭКГ и АД	0,5-5 мВ 30-350 мин <sup>-1</sup> 20-280 мм рт.ст.	ПГ ±10 % ПГ ±4 мин <sup>-1</sup> ПГ ±3 мм рт.ст.	
3	Пульсоксиметры	70-100 % 30-250 мин <sup>-1</sup>	ПГ ±5 % ПГ ±4 мин <sup>-1</sup>	
4	Мониторы (носимые, прикроватные, реанимационные, реаниматологические и др.)	0,03-5 мВ 10-350 мин <sup>-1</sup> 20-300 мм рт.ст. 15-250 мин <sup>-1</sup> 70-100 % 0-150 мин <sup>-1</sup> 20-50 °С	ПГ ±5 % ПГ ±3 мин <sup>-1</sup> ПГ ±5 мм рт.ст. ПГ ±3 мин <sup>-1</sup> ПГ ±2-3 % ПГ ±2 мин <sup>-1</sup> ПГ ±0,2 °С	
		0-20 кПа Каналы газового анализа: - закись азота 0,01-100 % - кислород 10-100 %	ПГ ±0,5 кПа    ПГ ±6 %  ПГ ±5 %	

**МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

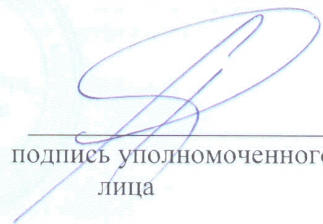
5	Анализаторы свертываемости крови (коагулометры)	3-1500 с	ПГ ±5 % ПГ ±3 с	
6	Анализаторы биохимические	0,1-2,0 Б 0,0001-3,0 Б	ПГ ±5 % ПГ ±5 %	
7	Анализаторы гематологические	лейкоциты (0,1-99,9) · 10 <sup>9</sup> дм <sup>-3</sup> эритроциты (0,02-9,99) · 10 <sup>12</sup> дм <sup>-3</sup> гемоглобин (15-300) г/дм <sup>3</sup>	ПГ ±15 %  ПГ ±10 %	

**ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ**

8	Рефрактометры, кератометры, авторефкератометры	(минус 30-25) дптр	ПГ ±0,25 дптр	
---	--	--------------------	---------------	--



Генеральный директор  
должность уполномоченного  
лица

  
подпись уполномоченного  
лица

Яковлев А.А.  
инициалы, фамилия  
уполномоченного лица