

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Сигнализаторы СТМ10

Назначение средства измерений

Сигнализаторы СТМ10 (далее – сигнализаторы) предназначены для непрерывного автоматического контроля дозврывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе рабочей зоны и выдачи сигнализации о превышении установленных пороговых значений.

Описание средства измерений

Тип сигнализаторов – стационарный, автоматический, блочно–модульной конструкции, одно- и многоканальный.

Принцип измерения сигнализаторов – термохимический.

Способ отбора пробы – диффузионный или принудительный, в зависимости от исполнения.

Режим работы – непрерывный.

Конструктивно сигнализатор состоит из:

- блока сигнализации и питания (БСП), включающего в себя модули измерительного преобразователя (МИП) (от одного до десяти), модуль преобразователя основного питания (МПОП) и модуль преобразователя резервного питания (МПП) (наличие модуля определяется исполнением сигнализатора);

- от одного до десяти выносных датчиков (ВД) или блоков датчиков (БД), подключаемых к БСП.

Перечень исполнений сигнализаторов приведен в таблице 1.

Сигнализаторы обеспечивают:

1) выдачу сигнализации ПОРОГ1 - непрерывной световой сигнализации красного цвета КОНЦЕНТР по каждому каналу, свидетельствующей о том, что содержание определяемых компонентов в контролируемой среде достигло порога срабатывания сигнализации «ПОРОГ1»;

2) выдачу сигнализации ПОРОГ2 - прерывистой световой сигнализации красного цвета КОНЦЕНТР по каждому каналу, свидетельствующей о том, что содержание определяемых компонентов в контролируемой среде достигло порога срабатывания сигнализации «ПОРОГ2»;

3) выдачу прерывистой световой сигнализации красного цвета ОТКАЗ о наиболее вероятной неисправности сигнализаторов (обрыв чувствительных элементов ВД);

4) переключение контактов для коммутации внешних цепей сигнализации при срабатывании сигнализации ПОРОГ1, ПОРОГ2;

5) переключение контактов для коммутации внешних цепей сигнализации неисправности ОТКАЗ;

6) переключение контактов для коммутации внешних цепей сигнализации ВКЛЮЧЕНО при включении сигнализатора (кроме сигнализаторов исполнений, соответствующих требованиям Правил Российского морского регистра судоходства);

7) индикацию измеренного значения концентрации (в сигнализаторах с цифровым отсчетным устройством).

Таблица 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69				
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП			
АПИ2.840.069	СТМ10-0010Дц УХЛ1	метан	10	1	-	10	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2			
-01	СТМ10-0010ДГц УХЛ1	гексан						+						
-02	СТМ10-0010Дб УХЛ1	метан						-						
-04	СТМ10-0010ДГбн УХЛ1	гексан						-	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-05	СТМ10-0010Дбн УХЛ1	метан						-						
-06	СТМ10-0010Дц ТВ3	метан						+						
-07	СТМ10-0010ДГц ТВ3	гексан						+						
-08	СТМ10-0010Дб ТВ3	метан				-								
-09	СТМ10-0010Пц УХЛ4	метан				-	10	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2				
-10	СТМ10-0010ПГц УХЛ4	гексан									+			
-11	СТМ10-0010Пб УХЛ4	метан									-			
-15	СТМ10-0010Пц ТВ3	метан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-16	СТМ10-0010ПГц ТВ3	гексан						+						
-17	СТМ10-0010Пб ТВ3	метан						-						
АПИ2.840.070	СТМ10-0009Рдц УХЛ1	метан						9	1	1	9	-	+	Общепромышленное
-01	СТМ10-0009РДГц УХЛ1	гексан				+								
-02	СТМ10-0009РДб УХЛ1	метан				-								
-06	СТМ10-0009Рдц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2								
-07	СТМ10-0009РДГц ТВ3	гексан	+											
-08	СТМ10-0009РДб ТВ3	метан	-											
-09	СТМ10-0009РПц УХЛ4	метан	-	9	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2							
-10	СТМ10-0009РПГц УХЛ4	гексан									+			
-11	СТМ10-0009РПб УХЛ4	метан									-			
-15	СТМ10-0009РПц ТВ3	метан			+	Экспортное	ТВ3				ТВ4.2			
-16	СТМ10-0009РПГц ТВ3	гексан			+									
-17	СТМ10-0009РПб ТВ3	метан			-									
-33	СТМ10-0009РДцм ОМ1	метан	9	-	+	Общепромышленное	ОМ1				ОМ4.2			
-34	СТМ10-0009РПцм ОМ4	метан	-	9	+							ОМ4		

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП
АПИ2.840.071	СТМ10-0008Дц УХЛ1	метан	8	1	-	8	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0008ДГц УХЛ1	гексан						+			
-02	СТМ10-0008Дб УХЛ1	метан						-			
-04	СТМ10-0008ДГбн УХЛ1	гексан						-	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0008Дбн УХЛ1	метан						-			
-06	СТМ10-0008Дц ТВ3	метан						+			
-07	СТМ10-0008ДГц ТВ3	гексан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-08	СТМ10-0008Дб ТВ3	метан						-			
-09	СТМ10-0008Пц УХЛ4	метан				+	-	8	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2
-10	СТМ10-0008ПГц УХЛ4	гексан				+					
-11	СТМ10-0008Пб УХЛ4	метан				-					
-15	СТМ10-0008Пц ТВ3	метан				+			Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-16	СТМ10-0008ПГц ТВ3	гексан				+					
-17	СТМ10-0008Пб ТВ3	метан				-					
АПИ2.840.072	СТМ10-0007РДц УХЛ1	метан				+					
-01	СТМ10-0007РДГц УХЛ1	гексан				+	7	-	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-02	СТМ10-0007РДб УХЛ1	метан				-					
-06	СТМ10-0007РДц ТВ3	метан	+								
-07	СТМ10-0007РДГц ТВ3	гексан	+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2					
-08	СТМ10-0007РДб ТВ3	метан	-								
-09	СТМ10-0007РПц УХЛ4	метан	+	-	7	Общепромышленное			УХЛ4	УХЛ4.2	
-10	СТМ10-0007РПГц УХЛ4	гексан	+								
-11	СТМ10-0007РПб УХЛ4	метан	-								
-15	СТМ10-0007РПц ТВ3	метан	+			Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-16	СТМ10-0007РПГц ТВ3	гексан	+								
-17	СТМ10-0007РПб ТВ3	метан	-								
-30	СТМ10-0007РДцм ОМ1	метан	7						-	+	Общепромышленное
-31	СТМ10-0007РПцм ОМ4	метан	-	7	+						

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69				
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП			
АПИ2.840.073	СТМ10-0006Дц УХЛ1	метан	6	1	-	6	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2			
-01	СТМ10-0006ДГц УХЛ1	гексан						+						
-02	СТМ10-0006Дб УХЛ1	метан						-						
-04	СТМ10-0006ДГбн УХЛ1	гексан						-	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1			
-05	СТМ10-0006Дбн УХЛ1	метан						-						
-06	СТМ10-0006Дц ТВ3	метан						+						
-07	СТМ10-0006ДГц ТВ3	гексан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-08	СТМ10-0006Дб ТВ3	метан				-								
-09	СТМ10-0006Пц УХЛ4	метан				+								
-10	СТМ10-0006ПГц УХЛ4	гексан				+	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2					
-11	СТМ10-0006Пб УХЛ4	метан				-								
-15	СТМ10-0006Пц ТВ3	метан				+								
-16	СТМ10-0006ПГц ТВ3	гексан				+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2					
-17	СТМ10-0006Пб ТВ3	метан				-								
АПИ2.840.074	СТМ10-0005РДц УХЛ1	метан				5	1	1	5	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0005РДГц УХЛ1	гексан									+			
-02	СТМ10-0005РДб УХЛ1	метан									-			
-06	СТМ10-0005РДц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3						ТВ4.2			
-07	СТМ10-0005РДГц ТВ3	гексан	+											
-08	СТМ10-0005РДб ТВ3	метан	-											
-09	СТМ10-0005РПц УХЛ4	метан	+	Общепромышленное	УХЛ4				УХЛ4.2					
-10	СТМ10-0005РПГц УХЛ4	гексан	+											
-11	СТМ10-0005РПб УХЛ4	метан	-											
-15	СТМ10-0005РПц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3				ТВ4.2					
-16	СТМ10-0005РПГц ТВ3	гексан	+											
-17	СТМ10-0005РПб ТВ3	метан	-											
-30	СТМ10-0005РДцм ОМ1	метан	5	-	+				Общепромышленное	ОМ1	ОМ4.2			
-31	СТМ10-0005РПцм ОМ4	метан	-	5	+							ОМ4		

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69				
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП			
АПИ2.840.075	СТМ10-0004Дц УХЛ1	метан	4	1	-	4	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2			
-01	СТМ10-0004ДГц УХЛ1	гексан						+						
-02	СТМ10-0004Дб УХЛ1	метан						-						
-04	СТМ10-0004ДГбн УХЛ1	гексан						-	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1			
-05	СТМ10-0004Дбн УХЛ1	метан						-						
-06	СТМ10-0004Дц ТВ3	метан						+						
-07	СТМ10-0004ДГц ТВ3	гексан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-08	СТМ10-0004Дб ТВ3	метан				-								
-09	СТМ10-0004Пц УХЛ4	метан				+								
-10	СТМ10-0004ПГц УХЛ4	гексан				+	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2					
-11	СТМ10-0004Пб УХЛ4	метан				-								
-15	СТМ10-0004Пц ТВ3	метан				+								
-16	СТМ10-0004ПГц ТВ3	гексан				+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2					
-17	СТМ10-0004Пб ТВ3	метан				-								
АПИ2.840.076	СТМ10-0003РДц УХЛ1	метан				3				1	1	3	-	+
-01	СТМ10-0003РДГц УХЛ1	гексан					+							
-02	СТМ10-0003РДб УХЛ1	метан					-							
-06	СТМ10-0003РДц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3		ТВ4.2							
-07	СТМ10-0003РДГц ТВ3	гексан	+											
-08	СТМ10-0003РДб ТВ3	метан	-											
-09	СТМ10-0003РПц УХЛ4	метан	+	Общепромышленное	УХЛ4		УХЛ4.2							
-10	СТМ10-0003РПГц УХЛ4	гексан	+											
-11	СТМ10-0003РПб УХЛ4	метан	-											
-15	СТМ10-0003РПц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3		ТВ4.2							
-16	СТМ10-0003РПГц ТВ3	гексан	+											
-17	СТМ10-0003РПб ТВ3	метан	-											
-30	СТМ10-0003РДцм ОМ1	метан	3	-	+		Общепромышленное	ОМ1	ОМ4.2					
-31	СТМ10-0003РПцм ОМ4	метан	-	3	+			ОМ4						

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69				
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП			
АПИ2.840.077	СТМ10-0002Дц УХЛ1	метан	2	1	-	2	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2			
-01	СТМ10-0002ДГц УХЛ1	гексан						+						
-02	СТМ10-0002Дб УХЛ1	метан						-						
-04	СТМ10-0002ДГбн УХЛ1	гексан						-	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1			
-05	СТМ10-0002Дбн УХЛ1	метан						-						
-06	СТМ10-0002Дц ТВ3	метан						+						
-07	СТМ10-0002ДГц ТВ3	гексан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2			
-08	СТМ10-0002Дб ТВ3	метан				-								
-09	СТМ10-0002Пц УХЛ4	метан				+								
-10	СТМ10-0002ПГц УХЛ4	гексан				+	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2					
-11	СТМ10-0002Пб УХЛ4	метан				-								
-15	СТМ10-0002Пц ТВ3	метан				+								
-16	СТМ10-0002ПГц ТВ3	гексан				+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2					
-17	СТМ10-0002Пб ТВ3	метан				-								
АПИ2.840.078	СТМ10-0001РДц УХЛ1	метан				1	1	1	1	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0001РДГц УХЛ1	гексан									+			
-02	СТМ10-0001РДб УХЛ1	метан									-			
-06	СТМ10-0001РДц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3						ТВ4.2			
-07	СТМ10-0001РДГц ТВ3	гексан	+											
-08	СТМ10-0001РДб ТВ3	метан	-											
-09	СТМ10-0001РПц УХЛ4	метан	+	Общепромышленное	УХЛ4				УХЛ4.2					
-10	СТМ10-0001РПГц УХЛ4	гексан	+											
-11	СТМ10-0001РПб УХЛ4	метан	-											
-15	СТМ10-0001РПц ТВ3	метан	+	Экспортное	ТВ3				ТВ4.2					
-16	СТМ10-0001РПГц ТВ3	гексан	+											
-17	СТМ10-0001РПб ТВ3	метан	-											
-30	СТМ10-0001РДцм ОМ1	метан	1	-	+				Общепромышленное	ОМ1	ОМ4.2			
-31	СТМ10-0001РПцм ОМ4	метан	-	1	+					ОМ4				

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Условное наименование сигнализаторов	Поворотный компонент	Количество					Наличие цифровой индикации	Исполнение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	
			МИП	МПОП	МПРП	ВД	БД			ВД или БД	БСП
АПИ2.840.079	СТМ10-0001Дц УХЛ1	метан	1	1	-	1	-	+	Общепромышленное	УХЛ1	УХЛ4.2
-01	СТМ10-0001ДГц УХЛ1	гексан						+			
-02	СТМ10-0001Дб УХЛ1	метан						-			
-04	СТМ10-0001ДГбн УХЛ1	гексан						-	Низкотемпературное	УХЛ1	УХЛ3.1
-05	СТМ10-0001Дбн УХЛ1	метан						-			
-06	СТМ10-0001Дц ТВ3	метан						+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2
-07	СТМ10-0001ДГц ТВ3	гексан						+			
-08	СТМ10-0001Дб ТВ3	метан				-					
-09	СТМ10-0001Пц УХЛ4	метан				+	Общепромышленное	УХЛ4	УХЛ4.2		
-10	СТМ10-0001ПГц УХЛ4	гексан				+					
-11	СТМ10-0001Пб УХЛ4	метан				-					
-15	СТМ10-0001Пц ТВ3	метан				+	Экспортное	ТВ3	ТВ4.2		
-16	СТМ10-0001ПГц ТВ3	гексан				+					
-17	СТМ10-0001Пб ТВ3	метан				-					

Внешний вид БСП с ВД приведен на рисунке 1 (а).
Внешний вид БД сигнализаторов приведен на рисунке 1 (б).
Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.




а) БСП с ВД




б) БД сигнализаторов

Рисунок 1 - Внешний вид БСП, ВД и БД сигнализаторов

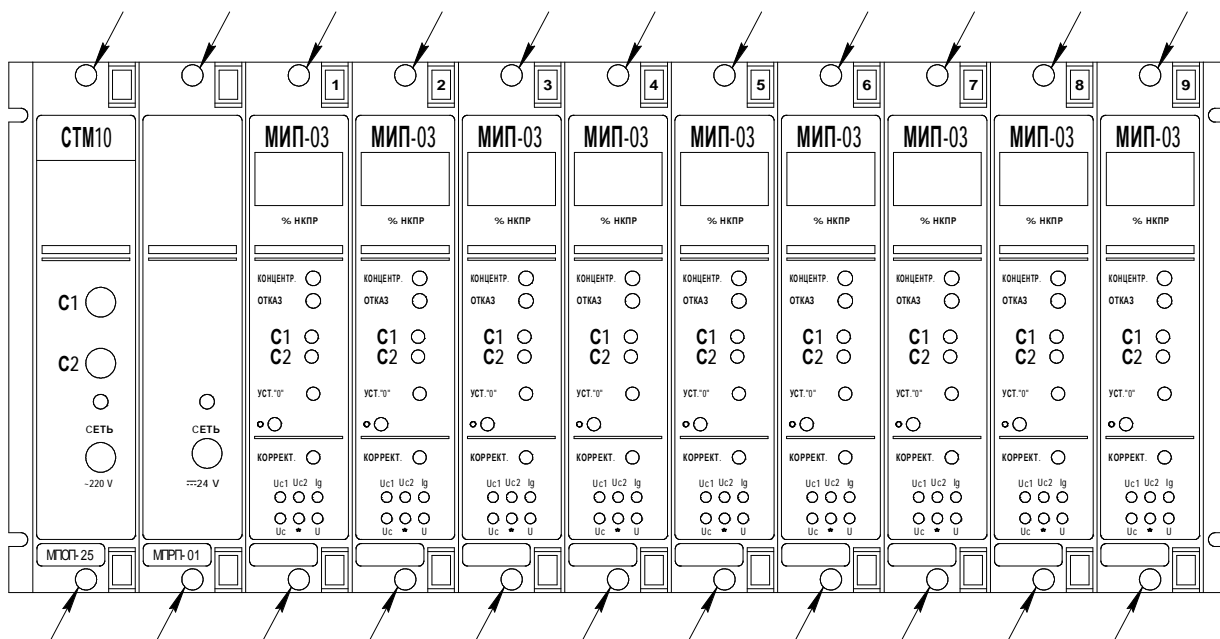

а) БСП

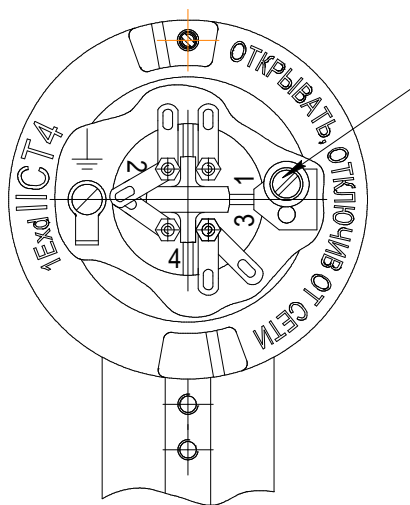

б) ВД

Стрелками указаны места пломбировки от несанкционированного доступа.

Рисунок 2 - Схема пломбировки сигнализаторов от несанкционированного доступа

Метрологические и технические характеристики

а) метрологические характеристики сигнализаторов

Номинальная функция преобразования сигнализаторов имеет вид:

1) по цифровому отсчетному устройству:

$$A = K_p \cdot C_{вх}, \quad (1.1)$$

где A - показания сигнализаторов по цифровому отсчетному устройству, % НКПР;

K_p - коэффициент пропорциональности, равный:

- для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном:

по метану - 1,00;

по гексану - 0,53;

по водороду - 1,20;

- для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном:

по гексану - 1,00;

по декану - 0,34;

по пропану - 1,30;

$C_{вх}$ - значение концентрации определяемого компонента на входе сигнализатора, % НКПР;

2) по выходному сигналу постоянного тока:

$$I = I_0 + K_i \cdot C_{вх}, \quad (1.2)$$

где I - значение сигнала постоянного тока, мА;

I_0 - начальный уровень выходного токового сигнала, равный 4 мА;

K_i - коэффициент пропорциональности, равный:

- для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном:

по метану - 0,32 мА/% НКПР;

по гексану - 0,17 мА/% НКПР;

по водороду - 0,38 мА/% НКПР;

- для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном:

по гексану - 0,320 мА/% НКПР;

по декану - 0,109 мА/% НКПР;

по пропану - 0,416 мА/% НКПР;

3) по выходному сигналу напряжения постоянного тока:

$$U = K_u \cdot C_{вх}, \quad (1.3)$$

где U - значение сигнала напряжения постоянного тока, мВ;

K_u - коэффициент пропорциональности, мВ/% НКПР, равный:

- для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном:

по метану - 10,0;

по гексану - 5,3;

по водороду - 12,0;

- для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном:

по гексану - 10,0;

по декану - 3,4;

по пропану - 13,0.

Диапазон измерений сигнализаторов по поверочному компоненту – метану или гексану (в зависимости от исполнения в соответствии с таблицей 2), % НКПР 0-50

Диапазон сигнальных концентраций сигнализаторов, % НКПР:
для сигнализаторов, кроме морского исполнения 5-50

для сигнализаторов морского исполнения 10-30

При выпуске из производства установлены следующие значения порогов срабатывания сигнализации, % НКПР:

для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном:	
- ПОРОГ 1	7
- ПОРОГ 2	11
для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном:	
- ПОРОГ 1	10
- ПОРОГ 2	15

б) характеристики погрешности сигнализаторов

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов (D_д) по поверочному компоненту, % НКПР, не более:

для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном	± 5,0
для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном	± 7,5

Пределы допускаемой вариации выходного сигнала сигнализаторов по поверочному компоненту не более ± 0,5D_д

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализаторов, % НКПР, не более ± 1,0

в) характеристики чувствительности сигнализаторов к влияющим величинам

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализаторов от изменения температуры окружающей среды в рабочем диапазоне температур на каждые 10 °С от номинального значения температуры (20 ± 5) °С, не более 0,2D_д

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализаторов от изменения атмосферного давления в диапазоне от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.), на каждые 3,3 кПа (25 мм рт.ст.) от номинального значения давления (101,3 ± 4,0) кПа ((760 ± 30) мм рт.ст.), не более 0,2D_д

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализаторов от изменения относительной влажности окружающей и контролируемой сред до 98 % при температуре 25 °С или 35 °С (тропическое исполнение), не более 1,0D_д

Сигнализаторы устойчивы к изменению параметров напряжения питания в пределах, оговоренных в КД

Сигнализаторы устойчивы к воздействию вибрации частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой не более 0,35 мм

Сигнализаторы морского исполнения устойчивы:

- к воздействию вибрации с частотой от 2 до 80 Гц;
- к воздействию ударов с ускорением 5 g и частотой от 40 до 80 ударов в минуту;
- к воздействию длительных наклонов до 22,5° от вертикали во всех направлениях, а также качки до 30° с периодом от 7 до 9 с;
- к воздействию морского тумана

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности сигнализаторов с принудительной подачей контролируемой среды от изменения давления в линии сжатого воздуха на ± 10%, % НКПР, не более ± 1,5

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализаторов (D_H) по неверочным компонентам, % НКПР, не более:

- для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном:	
по гексану	± 10
по водороду	± 5
- для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном:	
по декану	± 15
по пропану	± 7,5

г) динамические характеристики сигнализаторов

Время срабатывания сигнализации ПОРОГ1 и ПОРОГ2 при концентрации поверочного компонента в 1,6 раза превышающей пороговое значение, с, не более:

для сигнализаторов с поверочным компонентом метаном	10
для сигнализаторов с поверочным компонентом гексаном	20

Время непрерывной работы сигнализаторов без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора, ч, не менее 1080

д) технические характеристики сигнализаторов

Электрическое питание сигнализаторов осуществляется переменным однофазным током с напряжением (220_{-33}^{+22}) В и частотой (50 ± 1) Гц.

Электрическое питание сигнализаторов с модулем МППП, кроме того, может осуществляться от внешнего источника постоянного тока (резервного источника питания) с напряжением ($24_{-3,6}^{+2,4}$) В.

Переход на питание от резервного источника – автоматический в течение не более 1 мин.

Электрическое питание сигнализаторов морского исполнения осуществляется переменным однофазным током с номинальным значением напряжения 220 В при отклонении от минус 22 до плюс 13,2 В (длительный режим), от минус 66 до плюс 44 В (кратковременный режим в течение не более 1,5 с) и частотой ($50 \pm 2,5$) Гц (длительный режим) и (50 ± 5) Гц (кратковременный режим в течение не более 5 с).

Мощность, потребляемая сигнализаторами от сети переменного тока (В·А) или от источника постоянного тока (Вт), соответствуют указанным в таблице 2.

Сигнализаторы имеют унифицированные выходные сигналы согласно ГОСТ 26.011-80:

а) напряжения постоянного тока от 0 до 1 В.

Допустимое сопротивление нагрузки в цепи выхода напряжения должно быть не менее 10 кОм, пульсации - не более 6 мВ на сопротивлении 10 кОм;

б) постоянного тока от 4 до 20 мА.

Допустимое сопротивление нагрузки в цепи выхода постоянного тока должно быть не более 500 Ом, пульсации - не более 30 мВ на сопротивлении 500 Ом.

Габаритные размеры составных частей сигнализаторов соответствуют указанным в таблице 2.

Масса составных частей сигнализаторов соответствует указанной в таблице 3

Таблица 2

Условное обозначение сигнализатора	Габаритные размеры, мм, не более			Потребляемая мощность, В·А (Вт), не более
	БСП	ВД	БД	
СТМ-10-0010	460x202x282	137x77x71	235x130x300	60
СТМ-10-0009Р				54(50)
СТМ-10-0008	380x202x282			48
СТМ-10-0007Р				42(40)
СТМ-10-0006	300x202x282			36
СТМ-10-0005Р				30(28)
СТМ-10-0004	220x202x282			25
СТМ-10-0003Р				20(20)
СТМ-10-0002	140x202x282			15
СТМ-10-0001Р				10(10)
СТМ-10-0001	100x202x282			10

Таблица 3

Условное обозначение сигнализатора	Масса составных частей, кг, не более		
	БСП	ВД	БД
СТМ-10-0010Д	12	0,6	-
СТМ-10-0010П		-	3,0
СТМ-10-0009РД	12,2	0,6	-
СТМ-10-0009РП		-	3,0
СТМ-10-0008Д	9,0	0,6	-
СТМ-10-0008П		-	3,0
СТМ-10-0007РД	9,2	0,6	-
СТМ-10-0007РП		-	3,0
СТМ-10-0006Д	5,3	0,6	-
СТМ-10-0006П		-	3,0
СТМ-10-0005РД	5,5	0,6	-
СТМ-10-0005РП		-	3,0
СТМ-10-0004Д	4,5	0,6	-
СТМ-10-0004П		-	3,0
СТМ-10-0003РД	4,7	0,6	-
СТМ-10-0003РП		-	3,0
СТМ-10-0002Д	3,0	0,6	-
СТМ-10-0002П		-	3,0
СТМ-10-0001РД	3,2	0,6	-
СТМ-10-0001РП		-	3,0
СТМ-10-0001Д	2,1	0,6	-
СТМ-10-0001П		-	3,0

Условия эксплуатации сигнализаторов:

- 1) диапазон температуры окружающей среды:
 - для ВД климатического исполнения УХЛ1 - от минус 60 до плюс 50 °С;
 - для ВД климатического исполнения ТВ3 - от 1 до 50 °С;
 - для ВД климатического исполнения ОМ4 - от минус 60 до плюс 50 °С;
 - для БД - от 1 до 50 °С;
 - для БСП климатических исполнений УХЛ4.2, ТВ4.2, ОМ4.2 - от 1 до 50 °С;
 - для БСП климатического исполнения УХЛ3.1 - от минус 45 до плюс 50 °С;
- 2) диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.) – место размещения на высоте до 1000 м над уровнем моря;
- 3) диапазон относительной влажности воздуха:
 - для ВД - от 30 до 95 % при температуре 35 °С;
 - для БСП и БД – от 30 до 80 % при температуре 35 °С;
- 4) вибрации частотой от 10 до 55 Гц, амплитудой не более 0,35 мм;
- 5) содержание пыли не более 10 мг/м³;
- 6) напряженность внешнего однородного переменного магнитного поля не более 400 А/м;
- 7) напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м;
- 8) содержание каталитических ядов и агрессивных веществ в контролируемой среде, не входящих в перечень контролируемых веществ согласно таблице 1, не должно превышать предельно-допустимых концентраций (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005-88.

Примечания

1 Каталитические яды – вещества, снижающие каталитическую активность чувствительных элементов (ЧЭ) термохимического датчика (ТХД). Каталитическими ядами для ТХД являются галогены, сера, мышьяк, сурьма и их соединения, летучие соединения, содержащие атомы металлов, кремния, фосфора.

2 Агрессивные вещества – пары минеральных кислот и щелочей, газы и пары, вызывающие коррозию материалов огнепреградителя (оловянная бронза), токоподводов (проволока ДКРНМ) и ЧЭ ТХД (оксид алюминия, Pt-Pd чернь), элементов газового канала БД (латунь ЛС59-1, латунь Л63, бронза Бр КМц 3-1, поликарбонат ПК-ЛТ-10) в рабочих условиях эксплуатации сигнализаторов.

3 При больших концентрациях агрессивных веществ и каталитических ядов срок службы ЧЭ сокращается;

9) рабочее положение блоков сигнализаторов вертикальное, угол наклона в любом направлении не более 20°;

10) для сигнализаторов, соответствующих требованиям Правил Российского морского регистра судоходства:

- вибрация с частотой от 2 до 80 Гц;
- удары с ускорением 5 g при частоте от 40 до 80 ударов в минуту;
- длительные наклоны до 22,5° от вертикали во всех направлениях, а также при качке до 30° с периодом от 7 до 9 с;
- морской туман.

Средняя наработка на отказ сигнализаторов в условиях эксплуатации не менее 30000 ч для одного канала, при этом допускается замена ТХД или комплекта чувствительных элементов, выработавших свой ресурс.

Средний полный срок службы сигнализаторов в условиях эксплуатации для:

- БСП - 10 лет;
- ВД при условии, что содержание в контролируемой среде агрессивных веществ не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) согласно ГОСТ 12.1.005-88, – 10 лет;
- ВД при содержании в контролируемой среде агрессивных веществ, превышающем ПДК согласно ГОСТ 12.1.005-88, – 3 года;
- комплекта чувствительных элементов при условии отсутствия в анализируемой атмосфере каталитических ядов и агрессивных веществ, разрушающих токоподводы и ЧЭ ТХД, – 3 года;
- комплекта чувствительных элементов при наличии в анализируемой атмосфере каталитических ядов и агрессивных веществ, разрушающих токоподводы и ЧЭ ТХД – 1 год.

Сигнализаторы соответствуют требованиям к взрывозащищенному оборудованию по ТР ТС 012/2011 и относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы II.

ВД и БД сигнализаторов имеют маркировку взрывозащиты «IExdIICT4», взрывобезопасный уровень (1) взрывозащиты по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), обеспечиваемый видом «взрывонепроницаемая оболочка» (d) по ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998).

Сигнализаторы должны применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, требованиями ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП гл. 3.4), других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, и руководства по эксплуатации АПИ2.840.069 РЭ.

ВД и БД в составе сигнализаторов предназначены для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.

Блок сигнализации и питания (БСП) должен устанавливаться за пределами взрывоопасной зоны.

Части взрывонепроницаемой оболочки ВД выдерживают гидравлическое давление 1,5 МПа.

Газовый канал БД герметичен. Спад давления в течение 2 мин не превышает 2,9 кПа ($0,03 \text{ кгс/см}^2$) при избыточном давлении в системе 29,4 кПа ($0,3 \text{ кгс/см}^2$)

Оболочка ВД имеет высокую степень механической прочности по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).

Температура нагрева оболочки датчика в наиболее нагретом месте не превышает предельно допустимую для группы Т4 по ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)

Газоанализаторы соответствуют требованиям к электромагнитной совместимости по ТР ТС 020/2011, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522.1-2011.

По способу защиты персонала от поражения электрическим током сигнализаторы относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Степень защиты составных частей сигнализаторов по ГОСТ 14254-96:

- корпуса ВД – IP54;
- газопроницаемого стакана ВД – IP21;
- БД - IP54;
- БСП - IP20.

Знак утверждения типа

наносится

- 1) на титульный лист (центр листа) руководства по эксплуатации типографским способом;
- 2) на табличку, расположенную на газоанализаторе.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки сигнализаторов приведен в таблице 4.

Таблица 4

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Сигнализатор СТМ10	1 шт.	Согласно исполнению
	Комплект ЗИП	1 компл.	Согласно ведомости ЗИП конкретного исполнения
	Комплект монтажных частей	1 компл.	Согласно исполнению
	Ведомость эксплуатационных документов	1 экз.	Согласно исполнению
	Комплект эксплуатационных документов	1 компл.	Согласно ведомости эксплуатационных документов

Поверка

производится по документу АПИ2.840.069 РЭ «Сигнализаторы СТМ10. Методика поверки» (приложение А), утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 30 сентября 2010 г.

Поверка производится с использованием ГСО-ПГС, выпускаемых в баллонах под давлением по ТУ-6-16-2956-92. Основные средства поверки - воздух кл.1 ГОСТ 17433-80; ГСО 10095-2012, 10463-2014.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к сигнализаторам СТМ10

ГОСТ 8.578-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах

ГОСТ 27540-87 Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «Взрывонепроницаемая оболочка»

ГОСТ 12.2.091-2012 Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 51522.1-2011 ЭМС. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний

ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ТУ 25-7407.0016-88 Сигнализаторы СТМ10. Технические условия

ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений

Изготовитель

Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» (ФГУП «СПО «Аналитприбор»)

ИНН 6731002766

Адрес: 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3

Тел.: (4812) 31-12-42, факс: (4812) 31-75-16

Web-сайт: [http://: www.analitpribor-smolensk.ru](http://www.analitpribor-smolensk.ru)

E-mail: info@analitpribor-smolensk.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77/437-56-66

E-mail: office@vniims.ru,

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2020 г.