

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Генераторы сигналов произвольной формы WW5061, WW5062, WW1071, WW1072, WW2571, WW2572, WW1281

Назначение средства измерений

Генераторы сигналов произвольной формы WW5061, WW5062, WW1071, WW1072, WW2571, WW2572, WW1281 (далее - генераторы) предназначены для генерирования стандартных форм электромагнитных колебаний, электромагнитных колебаний с различными видами модуляции, а также электромагнитных колебаний произвольной формы в диапазоне частот от 0,1 МГц до 400 МГц по одному или двум каналам в зависимости от модели.

Описание средства измерений

Принцип работы генератора основан на воспроизведении сигналов с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) под управлением микропроцессора. Цифровые отсчеты с информацией о форме сигнала поступают из оперативной памяти прибора на ЦАП, который работает с переменной частотой дискретизации. Для формирования требуемой частоты выходного сигнала микропроцессор выбирает соответствующие значения частоты дискретизации и длины памяти с цифровыми отсчетами сигнала. Далее с ЦАП сигнал подается на выходной усилитель, фильтр и схему аттенуаторов, а затем на выходной разъем. В режиме генерирования сигналов произвольной формы настройку частоты дискретизации и длины памяти с цифровыми отсчетами сигнала производит пользователь, при этом доступна возможность управления памятью: деление ее на сегменты и формирование последовательностей сегментов с произвольным числом повторов. Дополнительный выход синхронизации позволяет получить сигнал, синфазный с основным сигналом, и с регулируемой задержкой между ними. Двухканальные модели генераторов генерируют синфазные сигналы по обоим каналам, что позволяет использовать их в качестве источников для векторной модуляции. Генераторы обеспечивают генерацию в режимах: непрерывном, с синхрозапуском (по внешнему сигналу, команде дистанционного управления или ручному запуску) и смешанном; а также поддерживают мультигенераторную синхронизацию для создания многоканальных систем.

В память генератора заложены стандартные сигналы различных форм, среди которых: синусоидальный, меандр, прямоугольный с регулируемой скважностью, треугольный, пилообразный и т. д. Для всех видов сигналов имеется возможность введения постоянного смещения. Предусмотрены режимы импульсной, амплитудной, частотной и фазовой модуляций (внутренней и внешней), частотной и фазовой манипуляций, режим качания частоты. Режим формирования сигналов произвольной формы, произвольных видов модуляции, управление памятью для создания последовательностей сегментов осуществляется с помощью специального программного обеспечения через внешний компьютер.

Генератор выполнен в корпусе настольного исполнения. На передней панели генератора расположены:

- табло для отображения режимов работы и значений параметров воспроизводимых сигналов;
- ряд кнопок, обеспечивающих выбор требуемых режимов работы и установку параметров;
- разъемы основных выходов прибора для выдачи различных видов сигналов и разъем выхода синхронизации;

На задней панели генератора расположены:


- разъем сетевого питания;
- интерфейсы дистанционного управления КОП, USB и LAN;
- разъемы выхода внутреннего опорного генератора и входа внешней опорной частоты;

- специальные разъемы для мультигенераторной синхронизации;
- разъем внешней синхронизации.


Модели генераторов различаются диапазоном частот дискретизации, разрядностью ЦАП и количеством каналов. Кроме этого, модели WW2571/2572 имеют 16-канальный параллельный логический выход для формирования цифровых последовательностей, а модель WW1281 – выход для формирования цифровых потоков последовательных данных.

Внешний вид микроомметров представлен на рисунке 1.

Генераторы применяются в лабораторных условиях при исследованиях, настройке и испытаниях систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении, машиностроении, геофизике, биофизике.

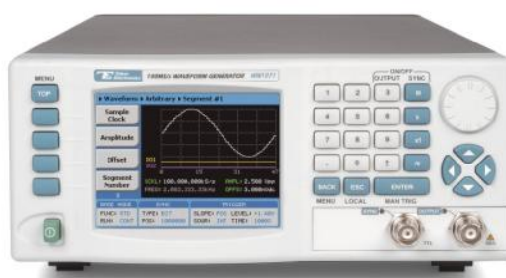

WW5061, WW1071, WW2571

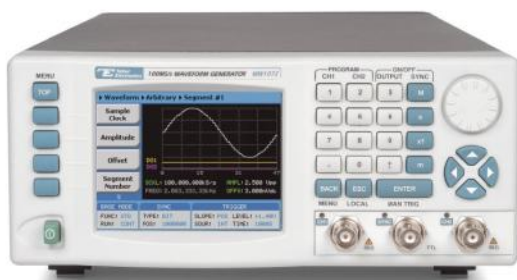

WW5062, WW1072, WW2572



WW1281

Рисунок 1. Внешний вид генераторов.

Программное обеспечение

Идентификационные данные метрологически значимой части программного обеспечения (ПО) указаны в таблице.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления идентификатора ПО
Встроенное	Микропрограмма	Не ниже v1.67 (для WW5061, WW1071) Не ниже v1.68 (для WW5062, WW1072) Не ниже v1.31 (для WW2571, WW2572) Не ниже v2.5b (для WW1281)	-	-

Встроенное ПО (микропрограмма) реализовано аппаратно и метрологические характеристики нормированы с его учётом. Микропрограмма заносится в программируемое постоянное запоминающее устройство и недоступна потребителю.

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «А» в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Основные параметры

Модель генератора	Количество каналов	Максимальная частота дискретизации $F_{\text{дискр}}$	Разрядность ЦАП	Количество точек памяти, $\times 10^6$
WW5061	1	50 МГц	14	0,5 (опция – 1)
WW5062	2	50 МГц	14	0,5 (опция – 1)
WW1071	1	100 МГц	14	1 (опция – 2)
WW1072	2	100 МГц	14	1 (опция – 2)
WW2571	1	250 МГц	16	1 (опция – 2)
WW2572	2	250 МГц	16	1 (опция – 2)
WW1281	1	1,2 ГГц	12	8 (опция – 16)

Частотные и временные параметры

Диапазон частот выходного сигнала		
Модель генератора	Вид выходного сигнала	
	Синус и меандр	произвольный
WW5061/5062	100 мкГц...25 МГц (синус до 50 МГц на доп. выходе)	Определяется формой сигнала и занимаемой полосой спектра
WW1071/1072	100 мкГц...50 МГц (синус до 50 МГц на доп. выходе)	
WW2571/2572	100 мкГц...100 МГц	
WW1281	50 Гц...400 МГц	
Начальная задержка между каналами		
Модель генератора	Основной канал и канал синхрозапуска	Между основными каналами для двухканальных моделей
WW5061/5062	$\pm(20 \text{ нс} + 1/F_{\text{дискр}})$	$\pm 2 \text{ нс}$
WW1071/1072		
WW2571/2572		
WW1281	$\pm(100 \text{ нс} + 1/F_{\text{дискр}})$	Не применимо

Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты: $\pm 1 \times 10^{-6}$

Параметры выходного напряжения

Модель генератора	WW5061/5062	WW1071/1072	WW2571/2572	WW1281
Диапазон установки размаха напряжения U_{pp} выходного сигнала на нагрузке 50 Ом	10 мВ...10 В	10 мВ...10 В	16 мВ...16 В	50 мВ...2 В
Диапазон установки постоянного смещения $U_{см}$ на нагрузке 50 Ом	0... $\pm 4,5$ В	0... $\pm 4,5$ В	0... $\pm 7,992$ В	0... ± 1 В
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки размаха синусоидального напряжения U_{pp} выходного сигнала на частоте 1 кГц на нагрузке 50 Ом	$\pm(0,01 \times U_{pp} + 2 \text{ мВ})$ от 10 до 100 мВ $\pm(0,01 \times U_{pp} + 5 \text{ мВ})$ от 0,1 до 1 В $\pm(0,01 \times U_{pp} + 25 \text{ мВ})$ от 1 до 10 В	$\pm(0,01 \times U_{pp} + 2 \text{ мВ})$ от 10 до 100 мВ $\pm(0,01 \times U_{pp} + 5 \text{ мВ})$ от 0,1 до 1 В $\pm(0,01 \times U_{pp} + 25 \text{ мВ})$ от 1 до 10 В	$\pm(0,01 \times U_{pp} + 5 \text{ мВ})$ от 16 до 160 мВ $\pm(0,01 \times U_{pp} + 10 \text{ мВ})$ от 0,16 до 1,6 В $\pm(0,01 \times U_{pp} + 70 \text{ мВ})$ от 1,6 до 12 В $\pm(0,02 \times U_{pp})$ от 12 до 16 В	$\pm(0,03 \times U_{pp} + 5 \text{ мВ})$

Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки напряжения смещения $U_{см}$ на нагрузке 50 Ом	$\pm(0,01 \times U_{см})$	$\pm(0,01 \times U_{см})$	$\pm(0,01 \times U_{см} + 5 \text{ мВ})$	$\pm(0,03 \times U_{см} + 50 \text{ мВ})$
Неравномерность АЧХ относительно частоты 1 кГц	Не более $\pm 5\%$ до 10 МГц Не более $\pm 20\%$ до 25 МГц	Не более $\pm 5\%$ до 10 МГц Не более $\pm 20\%$ до 50 МГц	Не более $\pm 5\%$ до 10 МГц Не более $\pm 20\%$ до 100 МГц	Не более 0,7 дБ до 200 МГц Не более 4 дБ до 400 МГц (опция - 1 дБ)

Параметры формы сигнала

Модель генератора	WW5061/5062	WW1071/1072	WW2571/2572	WW1281
Коэффициент нелинейных искажений до 100 кГц (не более)	0,1 % (0,05 % на доп. выходе)	0,1 % (0,05 % на доп. выходе)	0,1 %	0,5 %
Уровень гармонических составляющих синусоидального сигнала относительно уровня несущей (не более)	-50 дБн до 1 МГц -40 дБн до 5 МГц -35 дБн до 10 МГц -22 дБн до 25 МГц	-50 дБн до 1 МГц -40 дБн до 5 МГц -35 дБн до 10 МГц -22 дБн до 50 МГц	-48 дБн до 1 МГц -43 дБн до 10 МГц -30 дБн до 50 МГц -25 дБн до 100 МГц	-50 дБн до 10 МГц -45 дБн до 50 МГц -40 дБн до 125 МГц -30 дБн до 300 МГц -25 дБн до 400 МГц
Длительность фронта и среза сигнала типа меандр (не более)	10 нс	10 нс	4 нс	700 пс

Режимы модуляции

Модель генератора	WW5061/5062	WW1071/1072	WW2571/2572	WW1281
Частотная модуляция стандартным модулирующим колебанием	модуляция частоты опорного генератора	модуляция частоты опорного генератора	модуляция стандартным модулирующим колебанием	модуляция стандартным модулирующим колебанием
Частотная модуляция произвольным модулирующим колебанием (создается с помощью программного обеспечения)	модуляция частоты опорного генератора	модуляция частоты опорного генератора	модуляция произвольным модулирующим колебанием	модуляция произвольным модулирующим колебанием
Амплитудная модуляция	внешняя	внешняя	внутренняя/ внешняя	нет
Частотная манипуляция	внешняя	внешняя	внутренняя/ внешняя	внешняя
Фазовая манипуляция	нет	нет	внутренняя/ внешняя	внешняя
Режим качания частоты	есть	есть	есть	есть
Произвольная модуляция по амплитуде, частоте и фазе (создается с помощью программного обеспечения)	нет	нет	есть	нет

Условия эксплуатации и массогабаритные характеристики

Нормальные условия применения	Температура: (20±5) °С Относительная влажность воздуха: (30-80) % Атмосферное давление: (84-106) кПа
Хранение/транспортирование	Температура: (-10...+55) °С Относительная влажность воздуха: не более 85 % Атмосферное давление: (70-107) кПа
Масса	Не более 6 кг для WW1281 Не более 3,5 кг для остальных моделей
Геометрические размеры	212×88×415 мм
Питание прибора	(198 – 242) В, (48 –52) Гц, максимальная потребляемая мощность не более 60 Вт.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят типографским способом на обложку руководства по эксплуатации и на лицевую панель генератора в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Наименование	Количество	Примечание
Генератор (модель по заказу)	1 шт.	
Кабель питания	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	
Программное обеспечение	1 экз.	

Поверка

осуществляется в соответствии с разделом 7 «Методика поверки» Руководства по эксплуатации, утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в 2006 г.

Основные средства поверки:

- осциллограф LeCroy WR6200A;
- частотомер электронно-счетный ЧЗ-64;
- вольтметр универсальный В7-54;
- анализатор спектра Agilent 8596E;
- измеритель нелинейных искажений С6-11.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к генераторам сигналов произвольной формы WW5061, WW5062, WW1071, WW1072, WW2571, WW2572, WW1281

1. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
2. Техническая документация изготовителя.

Рекомендации по области применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

«Tabor Electronics, Ltd.», Израиль
9 Hatasia St., Tel Hanan, Israel
PO Box 404, Tel Hanan, Israel 20302.

Заявитель

Закрытое акционерное общество «Приборы, Сервис, Торговля» (ЗАО «ПриСТ»)
Адрес: 109444, г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9.
Тел. (495) 777-55-91, факс (495) 633-85-02,
E-mail: prist@prist.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений ФБУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 31
Тел. (499)129-19-11, факс (499)124-99-96
E-mail: info@rostest.ru
Аттестат аккредитации № 30010-10

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

М.п. «____» _____ 2012 г.