


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

СОГЛАСОВАНО

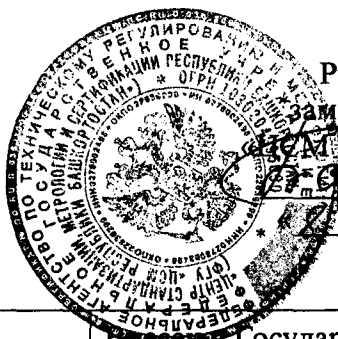

Руководитель ГЦИ СИ -
заместитель директора ФГУ
«ЦСМ» Республики Башкортостан»
Ю.Г. Баймуратов
» 02 2007 г.

<p>Комплекс измерительно-вычислительный 21-05-04-АИИКУУТЭ-4</p>	<p>Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>34642.04</u></p>
--	--

Изготовлен по технической документации ООО «Энергоинновация».
Заводской номер 01.

Назначение и область применения

Комплекс измерительно-вычислительный 21-05-04-АИИКУУТЭ-4 (далее – комплекс) предназначен для измерений параметров теплоносителя (конденсат) и вычисления массы, количества тепловой энергии и мощности.

Комплекс обеспечивает автоматизированный учет тепловой энергии, тепловой мощности, объема и массы теплоносителя, возвращаемого из системы технологического использования пара ОАО «Полиэф» на источник теплоты.

Комплекс относится к изделиям ИС-2 по ГОСТ 8.596.

Область применения – система коммерческого учета энергоносителей ОАО «Полиэф».

Описание

Принцип действия комплекса основан на преобразовании тепловычислителем СПТ 961 электрических сигналов, поступающих от измерительных преобразователей параметров конденсата (давления, температуры, объемного расхода) в цифровую информацию с последующим вычислением количества тепловой энергии и количества конденсата

Комплекс скомплектован на объекте сертифицированными средствами измерений и функциональным оборудованием, выпускаемыми по своей технической документации. В состав комплекса входят:

- тепловычислитель СПТ 961 (госреестр № 23665-02);
- расходомер электромагнитный ЭРИС-ВТ (госреестр № 12326-03);
- датчик давления Метран-55 (госреестр № 18375-03);
- термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП Метран-206 (госреестр № 19982-00);
- блоки питания измерительных преобразователей.

Комплекс выполняет в автоматическом режиме:

- измерение параметров теплоносителя (давление, температура, расход, объем);
- вычисление массы теплоносителя, тепловой мощности и количества тепловой энергии;

- регистрацию времени;
- регистрацию и архивирование измеренных и вычисленных параметров в энергонезависимой памяти;
- диагностику и архивирование параметров нештатных ситуаций;
- индикацию параметров на собственном табло;
- передачу информации на внешние устройства сбора данных посредством стандартных интерфейсов IEC 1107, RS 232, RS 485.

Основные технические характеристики

1. Рабочая среда (теплоноситель)	конденсат
2. Диапазоны измерений параметров:	
▪ избыточное давление, МПа	0,1...0,6
▪ температура теплоносителя, °С	20...90
▪ объемный расход, м ³ /ч	10...450
▪ массовый расход, т/ч	10...450
▪ масса теплоносителя, т	0...99999999
▪ тепловая энергия, ГДж (Гкал)	0...99999999
3. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении тепловой энергии, %:	
▪ при разности температур от 10 до 20°С	± 5
▪ при разности температур более 20°С	± 4
4. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массы (объема) теплоносителя в диапазоне расходов от 4 до 100%, %	± 2
5. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении давления теплоносителя, %	± 2
6. Параметры электрического питания функциональных блоков комплекса:	
а) вычислителя:	
- напряжение, В	220 ± 22
- частота, Гц	50 ± 1
б) измерительных преобразователей	в соответствии с их технической документацией
7. Условия эксплуатации функциональных блоков:	в соответствии с их технической документацией
8. Габаритные размеры функциональных блоков, мм, не более	450 x 420 x 390
9. Масса функциональных блоков, кг, не более	49
10. Полный средний срок службы, лет, не менее	12

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа комплекса нанесен на титульный лист паспорта.

Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Комплекс измерительно-вычислительный	21-05-04-АИИКУУТЭ-4	1	Состав согласно паспорту
Паспорт	КШЕН.421711.007 ПС	1	
Руководство по эксплуатации	КШЕН.421711.007 РЭ	1	
Эксплуатационная документация на функциональные блоки			Согласно комплекту поставки каждого блока

Поверка

Поверку комплекса проводят по методике поверки, приведенной в руководстве по эксплуатации КШЕН.421711.007 РЭ, согласованной с ГЦИ СИ ФГУ «ЦСМ Республики Башкортостан». Поверка функциональных блоков осуществляется в соответствии с их методиками поверки.

В состав основного оборудования, применяемого для поверки, входят:

- стенд СКС6 ТУ 4217-023-23041473-2000 производства НПФ «Логика»;
 - средства поверки в соответствии с методиками поверки составляющих комплекса.
- Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ Р 8.596 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем»;

ГОСТ Р 8.592 «ГСИ. Тепловая энергия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. типовая методика выполнения измерений»;

МИ 2553 «ГСИ. Энергия тепловая и теплоноситель в системах теплоснабжения. Методика оценивания погрешности измерений. Основные положения»;

МИ 2412 «ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнение измерений тепловой энергии и количества теплоносителя».


Заключение

Тип комплекса измерительно - вычислительного 21-05-04-АИИКУУТЭ-4 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоинновация»
450052, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 31,
тел., факс (347) 251 53 39

Генеральный директор
ООО «Энергоинновация»

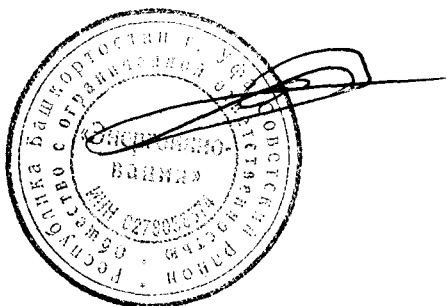

В.И. Гриднев