


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

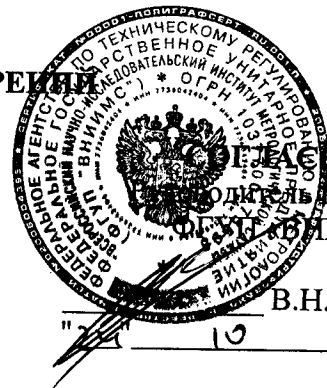

ОДНОВАННО
ОДК «СИ
ИИМС»

В.Н. Яншин
10 2008 г.

| | |
|--|--|
| <p>Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом модели R1T185H483-012-00-8RNDC31-T440-385U-S(10-290)C-I</p> | <p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 39028-08</p> |
|--|--|

Изготовлены по технической документации фирмы «Pyromation, Inc.», США.
Заводские номера: TT1580A, TT1580B.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом модели R1T185H483-012-00-8RNDC31-T440-385U-S(10-290)C-I (далее – термопреобразователи) предназначены для измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуре термопреобразователя газообразных и жидких сред в диапазоне от плюс 10 °С до плюс 290 °С и выдачи информации о значении температуры в виде выходного токового сигнала 4-20 мА.

Термопреобразователи применяются в составе паровых котлов типа 2D2C8.0 фирмы «Wellons Incorporated» (США), предназначенных для утилизации тепла, получаемого при сжигании древесных производственных отходов.

ОПИСАНИЕ

Термопреобразователи состоят из измерительной вставки с одним платиновым чувствительным элементом (ЧЭ) проволочного типа с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) типа «Pt100» по МЭК 60751/ГОСТ Р 8.625, соединенной с алюминиевой клеммной головкой, в которую встроен измерительный преобразователь. ЧЭ соединен с измерительным преобразователем по 3-х проводной схеме. Материал защитной арматуры измерительной вставки – нержавеющая сталь типа 316SS.

Принцип действия термопреобразователей основан на преобразовании измеряемой температуры в изменение электрического сопротивления ЧЭ с последующим преобразованием сопротивления в выходной сигнал постоянного тока при помощи измерительного преобразователя.

Монтаж термопреобразователей на объектах производится при помощи резьбового соединения (3/4" MNPT).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|------------------------|
| Диапазон измеряемых температур, °С: | от плюс 10 до плюс 290 |
| Диапазон изменения выходного сигнала, мА: | 4 ... 20 |
| Номинальное значение сопротивления ЧЭ термопреобразователя при 0 °С, Ом: | 100 |
| Температурный коэффициент ЧЭ термопреобразователя, α, °С ⁻¹ : | 0,00385 |
| Пределы допускаемого отклонения сопротивления ЧЭ от НСХ в температурном эквиваленте, °С (t – измеряемая температура): | ±(0,26 + 0,0042 t) |

| | |
|--|--|
| Пределы допускаемой основной погрешности измерительного преобразователя (при 23 ± 5 °С) °С: | $\pm 0,2$ °С или $\pm 0,08$ % (от диапазона измерений) (*) |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды (23 ± 5 °С) в диапазоне от минус 40 °С до плюс 85 °С, на 1 °С, °С: | $\pm 0,021$ |
| Пределы допускаемой основной суммарной погрешности термопреобразователя (при 23 ± 5 °С): °С: | $\pm(0,48 + 0,0042 t)$ |
| Напряжение питания, В: | 10 ... 30 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения напряжения питания от номинального значения (24 В), на 1 В, % (от диапазона измерений): | $\pm 0,01$ |
| Соотношение между напряжением источника питания и сопротивлением внешней нагрузки: | $R = (U - 10)/0,023$ |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения сопротивления нагрузки, на 100 Ом, % (от диапазона измерений): | $\pm 0,02$ |
| Длина монтажной части термопреобразователя, мм: | 304,8 |
| Диаметр монтажной части термопреобразователя, мм: | 6,35 |
| Рабочие условия эксплуатации термопреобразователей: | |
| - температура окружающей среды, °С: | от минус 40 до плюс 85 |
| - относительная влажность воздуха, %: | до 95. |

(*) Примечание: необходимо брать большее значение.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист технического описания методом штемпелевания.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- термопреобразователь – 2 шт.;
- паспорт – 2 экз.;
- техническое описание – 1 экз.;
- методика поверки – 1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка термопреобразователей проводится в соответствии с Инструкцией «Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом фирмы «Pyromation, Inc.», США. Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», октябрь 2008г.

Основные средства поверки:

- цифровой прецизионный термометр сопротивления ДТТ-1000, диапазон измеряемых температур : $-50 \dots +650$ °С; пределы допускаемой основной абсолютной погрешности в диапазоне: $-50 \dots +400$ °С: $\pm(0,03 + \text{ед. мл. разряда})$ °С;
- термостаты жидкостные моделей «ТЕРМОТЕСТ-100», «ТЕРМОТЕСТ-300», диапазон воспроизводимых температур ($-30 \dots +300$) °С, нестабильность поддержания заданной температуры $\pm(0,01 \dots +0,02)$ °С;
- однозначная мера электрического сопротивления эталонная Р3030, 10 Ом, кл.0,002;
- прецизионный преобразователь сигналов «ТЕРКОН», пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm(0,0005 + 5 \cdot 10^{-5} U)$ мВ;
- источник питания постоянного тока.

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.558-93. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры.

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 30232-94. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом. Общие технические требования

Международный стандарт МЭК 60751. Промышленные чувствительные элементы термометров сопротивления из платины.

ГОСТ Р 8.625-2006. ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом модели R1T185H483-012-00-8RNDC31-T440-385U-S(10-290)C-I утверждён с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма «Pyromation, Inc.», США.
Адрес: 5211 Industrial Road Fort Wayne, IN 46825 USA
Тел./факс: (260) 484-2580 / (260) 482-6805 или (800) 837-6805

ЗАЯВИТЕЛЬ: ООО «НГБ-Энергодиагностика»
Адрес: 115162, г.Москва, ул. Хавская, 11
Тел./факс: (495) 952-61-05/954-04-79

НС лаборатории термометрии
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

А.А. Игнатов

Генеральный директор
ООО «НГБ-Энергодиагностика»

В.А. Надеин

