



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

19 апреля 2019 г.

№ 850

Москва

О переоформлении и продлении срока действия свидетельства об утверждении типа средства измерений № 55009 «Счетчики газа ультразвуковые СГУ»

Во исполнение Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений, утверждённого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 ноября 2018 г. № 2346 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 февраля 2019 г. № 53732) (далее - Административный регламент), и в связи с обращениями АО «ИПФ «СибНА» от 27 февраля 2019 г. № 03-666 и № 03-667 п р и к а з ы в а ю:

1. Переоформить свидетельство об утверждении типа № 55009 «Счетчики газа ультразвуковые СГУ», зарегистрированное в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 57287-14, в связи с переименованием организации-изготовителя с открытое акционерное общество Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень на акционерное общество Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень.

2. Продлить срок действия свидетельства об утверждении типа средств измерений № 55009 «Счетчики газа ультразвуковые СГУ» на последующие 5 лет.

3. Управлению государственного надзора и контроля (А.М. Кузьмину), ФГУП «ВНИИМС» (А.Ю. Кузин) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельства с описанием типа средства измерений и выдачу его юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

Свидетельство о сертификате ЭП
Сертификат: 00E1036EE32711E880E9E0071BFC5DD276
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 08.11.2018 до 08.11.2019

С.С. Голубев



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.29.024.А № 55009/1

Срок действия до 19 апреля 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Счетчики газа ультразвуковые СГУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Инженерно-производственная фирма
"Сибнефтеавтоматика" (АО "НПФ "СибНА"), г. Тюмень

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 57287-14

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
373.00.00.000 МИ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года

Свидетельство об утверждении типа переоформлено и продлено приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 19 апреля 2019 г. № 850

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов

"....." 2019 г.

Серия СИ

№ 035711

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики газа ультразвуковые СГУ

Назначение средства измерений

Счётчики газа ультразвуковые СГУ (далее – счётчики) предназначены для измерения расхода и объёма потребляемого природного газа, попутного нефтяного газа и других газов (воздух, азот, кислород, и т. п.).

Описание средства измерений

Принцип работы счётчика состоит в измерении параметров газа в рабочих условиях (расхода, температуры, избыточного или абсолютного давления) с помощью соответствующих преобразователей и последующего вычисления объёма и расхода газа, приведённого в соответствии с ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ Р 8.741-2011 к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63.

Состав счётчика (базовой комплектации, на один трубопровод) приведён в таблице 1:

Таблица 1 — Состав счетчика СГУ

Наименование составной части изделия	Количество для модификации	
	СГУ.1	СГУ.2
Составные части изделия:		
Блок вычисления расхода микропроцессорный БВР.М	1*	1*
Контроллер универсальный МИКОНТ-186	1*	1*
Датчик расхода газа ДРУ.1	1	-
Датчик расхода газа ДРУ.2	-	1
Термопреобразователь с унифицированным токовым выходным сигналом 4-20 мА ТСМУ, ТСПУ; пределы основной приведённой погрешности $\pm 0,25\%$, $\pm 0,5\%$	1*	1*
Термопреобразователь сопротивления типа ТСМ с номинальной статической характеристикой 100М по ГОСТ 6651-2009	1*	1*
Датчик абсолютного или избыточного давления с токовым выходным сигналом 4-20 мА; пределы основной приведенной погрешности не более $\pm 0,1\%$, $\pm 0,15\%$, $\pm 0,2\%$, $\pm 0,25\%$ (типа "Метран", "Элемер" или аналогичный по ГОСТ 22520-85)	1	1
Примечание: * - Комплектность устанавливается заказчиком		

Расход и объём газа измеряются с помощью ультразвуковых датчиков расхода газа ДРУ, обеспечивающих линейное преобразование объёмного расхода газа в рабочих условиях в импульсный электрический сигнал с нормированной ценой и токовый сигнал 4-20 мА.

Температура измеряется с помощью датчиков температуры с токовым выходным сигналом 4-20 мА, или с помощью термопреобразователей сопротивления типа ТСМ с номинальной статической характеристикой 100М по ГОСТ 6651-2009;

Давление измеряется с помощью датчиков абсолютного или избыточного давления с токовым выходным сигналом 4-20 мА.

Сигналы от измерительных преобразователей поступают на входы блока вычисления расхода микропроцессорного БВР.М или контроллера универсального МИКОНТ-186 (далее – контроллер МИКОНТ), осуществляющих вычисление расхода и объёма газа, приведённых к стандартным условиям в соответствии с установленным алгоритмом.

Датчики расхода газа ДРУ, входящие в состав счётчиков, могут поставляться отдельно в качестве измерительных преобразователей объёма и объёмного расхода газа в рабочих условиях для использования в составе любых систем, измерительных комплексов и других изделий, обеспечивающих приём и обработку импульсных сигналов с максимальной частотой 1000 Гц, или токовых сигналов 4-20 мА.

Датчики расхода газа ДРУ одного типоразмера являются взаимозаменяемыми.

Счётчики СГУ имеют две модификации по исполнению – СГУ.1 (с однолучевым датчиком расхода ДРУ.1) и СГУ.2 (с двухлучевым датчиком расхода ДРУ.2) и типоразмеры в соответствии с типоразмерами датчиков расхода, входящими в состав счётчика.

Блок БВР.М и контроллер МИКОНТ обеспечивают выполнение следующих функций:

- приём и обработку сигналов, поступающих с датчиков расхода, давления и температуры;
- вычисление объёма газа, приведенного стандартным условиям по ГОСТ 2939-63;
- измерение времени работы при включенном питании и индикацию часов реального времени;
- регистрацию и накопление информации об объёме газа, в рабочих условиях и приведенных к стандартным условиям, времени работы счетчика и архивирование, в т.ч. среднечасовых значений параметров газа: расход, давление, температура;
- передачу информации на верхний уровень с помощью стандартного интерфейса RS232 или RS485 и информации об объёме газа в виде импульсного сигнала;
- отображение текущих параметров потока газа, текущей информации о среднечасовых и итоговых параметрах на экране индикатора-дисплея;
- запись сохраняемой информации на карту памяти по запросу оператора с помощью встроенного считывателя;
- автоматическое сохранение информации (архивов) при отключении питания;
- защита от несанкционированного изменения настроечных параметров.

Типоразмеры и модификации счётчиков СГУ определяются типоразмерами и модификациями датчиков расхода ДРУ. Типоразмеры и модификации счётчика СГУ базовой комплектации и диапазоны эксплуатационных расходов газа (при рабочих условиях) приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Типоразмеры и модификации счетчиков СГУ

Типоразмер и модификация счётчика СГУ	Типоразмер и модификация датчика расхода	Диаметр условного прохода трубопровода Ду, мм	Избыточное давление измеряемой среды в диапазоне, МПа	Диапазон эксплуатационных скоростей (расходов), м/с (М ³ /ч)	
				V _{min} (Q _{min})	V _{max} (Q _{max})
1	2	3	4	5	6
СГУ.1-50	ДРУ.1-50	50	от 0 до 2,5 от 0 до 4,0	0,35 (2)	34,9 (200)
СГУ.1-80	ДРУ.1-80	80		0,31 (5)	34,6 (550)
СГУ.1-100	ДРУ.1-100	100		0,31 (7)	34,9 (800)
СГУ.1-150	ДРУ.1-150	150		0,31 (17)	34,3 (1900)
СГУ.1-200	ДРУ.1-200	200		0,32 (35)	33,1 (3600)
СГУ.1-300	ДРУ.1-300	300		0,31 (80)	29,9 (7600)
СГУ.2-100	ДРУ.2-100	100		0,31 (7)	34,9 (800)
СГУ.2-150	ДРУ.2-150	150		0,31 (17)	34,3 (1900)

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6
СГУ.2-200	ДРУ.2-200	200	от 0 до 2,5	0,32 (35)	33,1 (3600)
СГУ.2-300	ДРУ.2-300	300	от 0 до 4,0	0,31 (80)	29,9 (7600)

Программное обеспечение

Блок БВР.М выполнен на базе микроконтроллера, встроенное ПО имеет идентификационные данные, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 — Идентификационные данные ПО блока БВР.М

Идентификационные данные (признаки)	ПО БВР.М в составе счетчика газа	ПО БВР.М в составе счетчика свободного нефтяного газа
Идентификационное наименование ПО	СВГ+СЖУ	СВГ-ПНГ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	v002m	v002m
Цифровой идентификатор ПО	0x1775	0xA0F5
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC16	CRC16

Контроллер МИКОНТ выполнен на базе микропроцессора, встроенное ПО имеет идентификационные данные, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 — Идентификационные данные ПО контроллера МИКОНТ

Идентификационные данные (признаки)	Встроенное программное обеспечение контроллера универсального МИКОНТ-186
Идентификационное наименование ПО	ЭНЕРГОУЧЕТ
Номер версии (идентификационный номер) ПО	F348_2G1St5W
Цифровой идентификатор ПО	0xF7CC
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC16

Электронный преобразователь датчика расхода ДРУ выполнен на базе микроконтроллера, встроенное ПО имеет идентификационные данные, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 — Идентификационные данные ПО датчика расхода ДРУ

Идентификационные данные (признаки)	ПО МП ДРУ	ПО ИМ ДРУ
Идентификационное наименование ПО	USFM_PM_FW	USFM_MM_FW
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.1.01	4.1.01
Цифровой идентификатор ПО	CRC 0xD145	CRC 0xFAB7
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC16	CRC16

Уровень защиты ПО – «С».

Схема размещения пломб поверителя представлена на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1 — Счётчик газа ультразвуковой СГУ.1

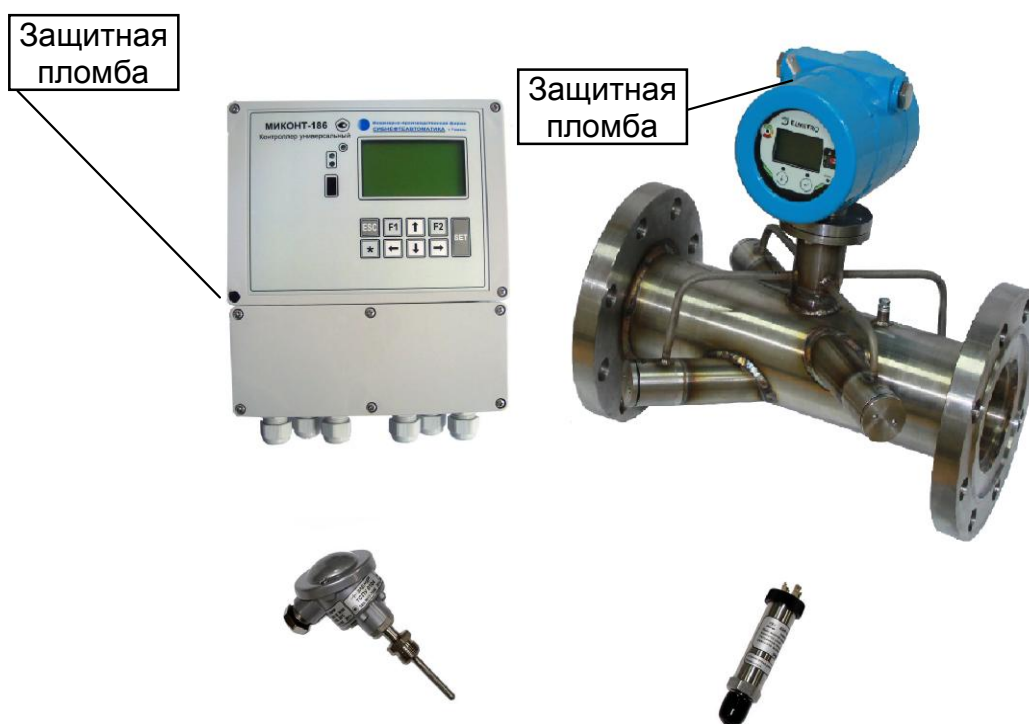


Рисунок 2 — Счётчик газа ультразвуковой СГУ.2

Метрологические и технические характеристики

Таблица 6 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой относительной погрешности датчика расхода ДРУ, %, при преобразовании расхода газа в рабочих условиях (в диапазоне эксплуатационных расходов) в частотный сигнал: - ДРУ.1: в диапазоне от Q_{\min} до $0,03Q_{\max}$, % в диапазоне от $0,03Q_{\max}$ до Q_{\max} , % - ДРУ.2 в диапазоне от Q_{\min} до $0,03Q_{\max}$, % в диапазоне от $0,03Q_{\max}$ до Q_{\max} , %	$\pm 2,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$ $\pm 1,0$
Пределы допускаемой приведенной погрешности датчиков расхода ДРУ.1, ДРУ.2, %, при преобразовании расхода газа в рабочих условиях (в диапазоне эксплуатационных расходов) в токовый сигнал 4-20 мА	$\pm 1,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне эксплуатационных расходов: для СГУ.1, % для СГУ.2, %	$\pm 2,0$; $\pm 2,5$ $\pm 1,5$; $\pm 2,0$; $\pm 2,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры газа, °С	$\pm 0,8$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении избыточного давления газа, %	$\pm 0,85$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении времени работы, %	$\pm 0,1$
Примечание – Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении избыточного давления газа нормированы в диапазоне от 30% до 100% верхнего предела датчика давления.	

Таблица 7 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Диапазон измерений температуры, °С	от -50 до +50
Диапазон измерений давления, МПа: избыточного абсолютного	от 0 до 4 от 0,5 до 5
Число индицируемых разрядов, отображающих информацию об объеме газа нарастающим итогом, не менее	6
Цена единицы младшего разряда, отображающего информацию об объеме газа нарастающим итогом, м ³	10^{-n}
Температура окружающей среды: для датчиков расхода, температуры и давления, °С для блока БВР.М и контроллера МИКОНТ, °С	от -40 до +50 от +5 до +50
Параметры электрической сети питания счётчика: – напряжение, В – частота, Гц	220 ± 22 50 ± 1
Потребляемая мощность счётчика при подключенных датчиках в базовой комплектации, В•А, не более	25
Максимальная длина линии связи между датчиками и вычислителем, м, не более	500

Продолжение таблицы 7

1	2
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-96: блока БВР.М и контроллера МИКОНТ датчика расхода ДРУ	IP40 IP65
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330.14	1ExdIICT6X
Габаритные размеры датчика расхода ДРУ, мм, не более	670x550x660
Масса счётчика в упаковке, кг, не более	230
Средняя наработка на отказ, ч	75000
Средний срок службы, лет	12
Примечание – n=0, 1, 2...5	

Знак утверждения типа

наносится на эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, паспорт счётчика газа) типографским способом, на корпуса вычислителей методом наклейки, на таблички, размещённые на корпусе датчика методом шелкографии.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки счётчиков соответствует таблице 8.

Таблица 8 — Комплект поставки счётчиков СГУ

Обозначение	Наименование	Количество
	Счётчик газа ультразвуковой СГУ	1*
373.01.00.000 РЭ	Датчик расхода газа ультразвуковой СГУ. Руководство по эксплуатации	1
373.01.00.000 ПС	Датчик расхода газа ультразвуковой ДРУ. Паспорт	1
373.00.00.000 РЭ	Счётчик газа ультразвуковой СГУ. Руководство по эксплуатации.	1
373.00.00.000 ПС	Счётчик газа ультразвуковой СГУ. Паспорт.	1
373.00.00.000 МИ	Инструкция. ГСИ. Счётчики газа ультразвуковые СГУ. Методика поверки.	1
* - Определяется в соответствии с заказом согласно таблице 1.		

Поверка

осуществляется по документу 373.00.00.000 МИ «Инструкция. ГСИ. Счётчики газа ультразвуковые СГУ. Методика поверки», утверждённой ФБУ «Тюменский ЦСМ» 18.03.2013 г.

Основные средства поверки:

Установка поверочная газовая УПГ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – регистрационный номер) 26638-04.

Калибратор измерительных каналов КИК-М, регистрационный номер 32639-06.

Магазин сопротивления Р4831, регистрационный номер 6332-77.

Средства поверки для средств измерений, входящих в состав СГУ указаны в документах на их поверку.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке СГУ.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений приведены в руководстве по эксплуатации 373.00.00.000 РЭ «Счётчик газа ультразвуковой СГУ. Руководство по эксплуатации»

ГОСТ Р 8.740-2011. ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков

ГОСТ Р 8.741-2011. ГСИ. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам газа ультразвуковым СГУ

ТУ 4213-028-12530677-2012 Счётчики газа ультразвуковые СГУ. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика»
(АО «ИПФ «СибНА»)

ИНН 7203069360

Адрес: 625014, г. Тюмень, ул. Новаторов, 8

Телефон: (3452)-22-54-60

Факс: (3452)-22-55-29

Web-сайт: www.sibna.ru

E-mail: sibna@sibna.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Ямало-Ненецком автономном округе»

(ФБУ «Тюменский ЦСМ»)

Адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Минская, д. 88

Телефон: (3452) 20-62-95

Факс: (3452) 28-00-84

Web-сайт: тцсм.рф

E-mail: mail@csm72.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Тюменский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30024-11 от 08.08.2011 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п.

« ____ » _____ 2019 г.